

FLACHSTRICK MASSBESTELLUNG

VenoTrain® curaflow

221

Klinik

221



Kundenname: _____ Kundennr.: _____

Ansprechpartner: _____

Bestelldatum: _____ Letzte Auftrags-Nr.: _____

Kommission: _____

Kostenvoranschlag Bestellung

Bauerfeind AG
Tel. 08 00 - 001 05 60
Fax 08 00 - 001 05 65

Österreich
Tel. +43 (0) 800 44 30 130
Fax +43 (0) 800 44 30 131

Schweiz
Tel. +41 (0) 56 485 82 42
Fax +41 (0) 56 485 82 59

Unterschrift/Firmenstempel: _____

Bein

Farben Creme Caramel Schwarz
 Anthrazit Marine Bordeaux

Kompression Ccl1 Ccl2 Ccl3 Ccl4

linkes Bein

rechtes Bein

Leibteil

Anzahl Paar _____ Stück _____

*Farben Anthrazit, Marine und Bordeaux nicht als Klinikversorgung lieferbar.

Strumpf:

AD

AG

Beinstück _____

Abschluss:

Noppenhaftband

breit (4,7 cm)

schmal (2,5 cm)

Hüftbefestigung

Streifenhaftband

seitlich schräger Abschluss

Beinerhöhung vorn

Hose:

Hose AT

Umstandshose ATU

Einbeinhose ATE

Leggin BT

Leggin B1T

Caprihose CT

Bermuda ET

Radlerhose FT

zweiteilig

Taille Abschluss:

Noppenhaftband

Tailenband

Abschluss mit Kompression

Loch-/Durchziehgummi

Zusätze:

ohne Kniezone/Knieellipse

Reißverschluss*

Futterstoff*

Haftbandst. innen* breit (4,7 cm)

schmal (2,5 cm)

Damenzwinkel:

Standard offen

kompressiv

Herrenzwinkel:



Standard mit Eingriff

kompressiv

*Länge und Lage unter Sonderwünsche

Alle Angaben in cm. Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Sonderwünsche: _____

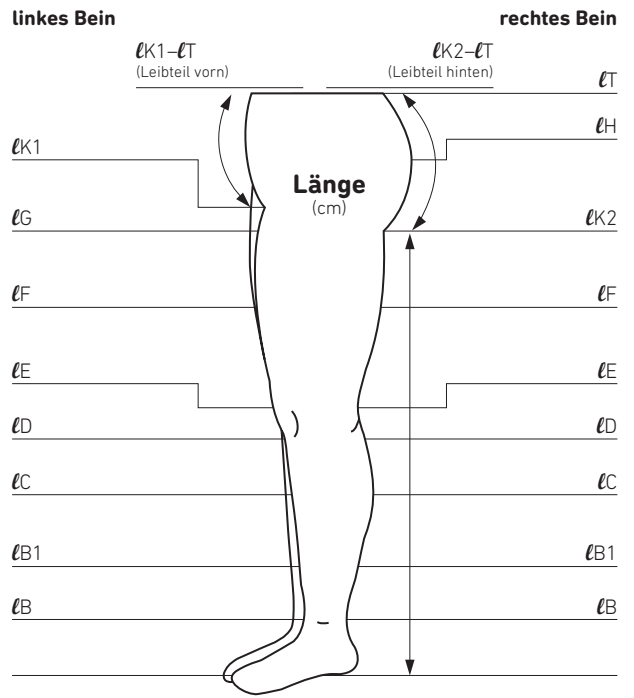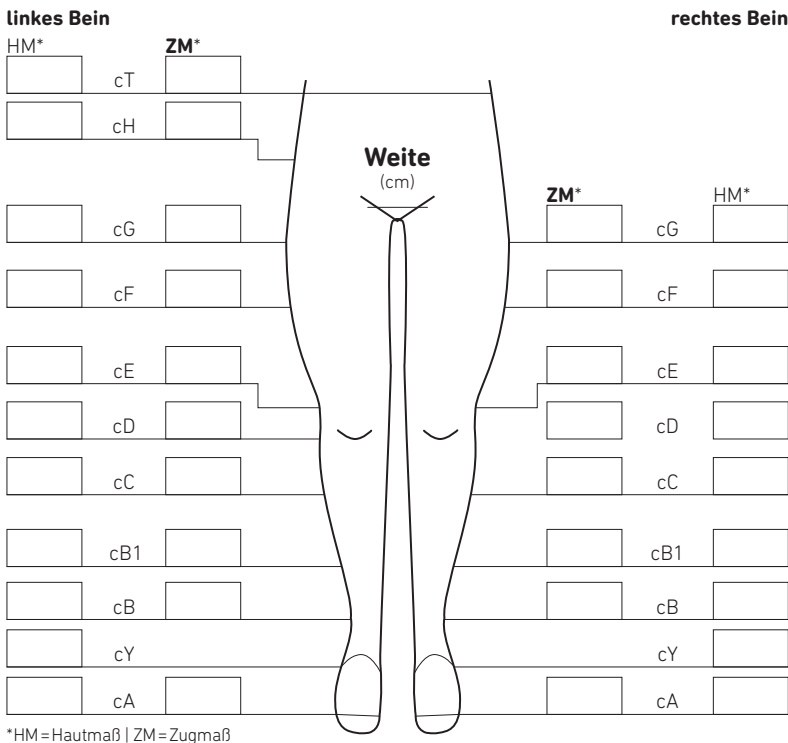

*HM = Hautmaß | ZM = Zugmaß

Druck-Pelotte:

links

rechts

medial

lateral

Lymphpad

Schaumstoff

Silikon

nur Tasche

Maßangaben für Druck-Pelotte

links: P1 _____ cm P2 _____ cm

rechts: P1 _____ cm P2 _____ cm

provisorische Naht

Hallux

anatomischer Fuß

links rechts

cA1 _____ cm cA1 _____ cm

lA1* _____ cm lA1* _____ cm

* ist die Länge von Ferse bis Messpunkt cA1

linker Fuß **Fuß** **rechter Fuß**

lA außen _____ Länge _____ außen lA

lAi innen _____ innen lAi

lZ gesamt _____ gesamt lZ

Fuß gerade **Fuß schräg**

offen offen

geschl. geschl.

90° Ferse Spannerweiterung